



**Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОМИССИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ИСПЫТАНИЮ И ОХРАНЕ СЕЛЕКЦИОННЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ"**

ПРИКАЗ

от 6 октября 2016 года N 335

**Об обязательной экспертизе на наличие генно-инженерных конструкций в сортах
сельскохозяйственных культур, включаемых в Государственный реестр селекционных
достижений, допущенных к использованию**

Во исполнение Федерального закона от 17 декабря 1997 года N 149-ФЗ "О семеноводстве", Федерального закона от 3 июля 2016 года N 358-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования в области генно-инженерной деятельности", Указа Президента Российской Федерации "О мерах по реализации государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства" от 21 июля 2016 года N 350, поручения Президента Российской Федерации ПР1178 от 22 июля 2016 года об обязательной экспертизе на содержание ГМ-организмов при регистрации новых видов сельскохозяйственной продукции

приказываю:

1. Всероссийскому центру по оценке качества сортов сельскохозяйственных культур - филиалу ФГБУ "Госсорткомиссия" (далее - ВЦОКС филиал ФГБУ "Госсорткомиссия"):

1.1 в соответствии с Методическими указаниями по детекции и идентификации специфических последовательностей ДНК генно-инженерно-модифицированных организмов методом ПЦР в режиме реального времени в матричном формате проводить обязательную экспертизу на наличие генно-инженерных конструкций (далее - экспертиза) в сортах сельскохозяйственных культур (согласно приложению к настоящему приказу), включаемых в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию;

1.2 оформлять итоги экспертизы протоколом и направлять его в ФГБУ "Госсорткомиссия".

2. Отделам по культурам ФГБУ "Госсорткомиссия" ежегодно до 10 декабря составлять перечень сортов сельскохозяйственных культур, по которым необходимо провести экспертизу и направлять его ВЦОКС филиалу ФГБУ "Госсорткомиссия".

3. Отделам по культурам совместно с отделом регистрации и госреестров ФГБУ "Госсорткомиссия" уведомлять заявителей о необходимости ежегодной поставки ВЦОКС филиалу ФГБУ "Госсорткомиссия" (почтовый адрес: ул.Лиственничная аллея, 6, г.Москва, 127550) образцов семян согласно разрядке ФГБУ "Госсорткомиссия" не позднее 10 декабря, в количестве согласно приложению к настоящему приказу. Образцы семян должны сопровождаться этикеткой, на которой указываются: название культуры, сорта, размер образца, год производства семян, репродукция, наименование заявителя и поставщика семян. Этикетка прикрепляется с внешней стороны тары таким образом, чтобы ее нельзя было удалить случайным образом, второй



экземпляр этикетки вкладывается внутрь тары.

4. Заместителю председателя ФГБУ "Госсорткомиссия" Ю.Л.Гончарову считать непоставку образцов семян отказом заявителя от проведения государственных испытаний и заявку на данный сорт отозванной.

5. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на заместителя председателя ФГБУ "Госсорткомиссия" Ю.Л.Гончарова.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

7. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Председатель
ФГБУ "Госсорткомиссия"
В.С.Волощенко

Приложение
к приказу ФГБУ "Госсорткомиссия"
от 6 октября 2016 года N 335

Перечень родов и видов сельскохозяйственных культур, сорта которых подлежат проверке на наличие в них генно-инженерных конструкций и количество семян, необходимое для проведения указанной проверки

Русское название культуры	Латинское название культуры	Количество семян
Кукуруза	ZEA MAYS L.	100 грамм
Соя	GLYCINE MAX (L.) MERR.	100 грамм
Сахарная свекла	BETA VULGARIS L. SSP. VULGARIS VAR. SACCHARIFERA ALEF.	100 грамм
Рапс	BRASSICA NAPUS L.	100 грамм
Картофель	SOLANUM TUBEROSUM L.	10 клубней
Томаты	SOLANUM LYCOPERSICUM L. VAR. LYCOPERSICUM	5 грамм
Хлопчатник	GOSSYPIUM HIRSUTUM L.	100 грамм



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ДЕТЕКЦИИ И ИДЕНТИФИКАЦИИ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ДНК ГЕННО-ИНЖЕНЕРНО-МОДИФИЦИРОВАННЫХ ОРГАНИЗМОВ МЕТОДОМ ПЦР В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ В МАТРИЧНОМ ФОРМАТЕ

В методике рассмотрена процедура проведения анализа, направленного на детекцию и идентификацию генно-инженерно-модифицированных организмов. Указанной процедуре могут быть подвергнуты ткани растений (семена, плоды, корнеплоды, зеленая масса), растительное сырье и продукты его переработки.

Методика предназначена для специалистов профильных лабораторий, осуществляющих исследования на выявление и идентификацию ГМО.

Методика подготовлена коллективом авторов:

Александр Григорьевич Голиков - научный руководитель ООО "ГенБит";

Артур Сергеевич Домблидес - заведующий лабораторией генетики ФГБНУ ВНИИССОК;

Дмитрий Борисович Дорохов - ведущий научный сотрудник "Федерального исследовательского центра по проблемам фундаментальной биотехнологии" РАН;

Александра Юрьевна Драгович - руководитель Центра молекулярной биотехнологии ФГБНУ ИОГен им.Н.И.Вавилова;

Геннадий Ильич Карлов - руководитель Центра молекулярной биотехнологии РГАУ-МСХА им.К.А.Тимирязева;

Андрей Анатольевич Поморцев - ведущий научный сотрудник ФГБНУ ИОГен им.Н.И.Вавилова;

Владимир Петрович Упелник - ведущий научный сотрудник ФГБНУ ИОГен им.Н.И.Вавилова;

Максим Михайлович Никитин - руководитель группы молекулярной биологии ООО "ГенБит";

Андрей Борисович Комаров - директор по развитию ООО "Компания "БИОКОМ";

Павел Александрович Французов - руководитель группы биохимии ООО "ГенБит".

Рецензенты:

Г.И.Карлов - руководитель Центра молекулярной биотехнологии РГАУ-МСХА им.К.А.Тимирязева;

С.В.Долгов - заведующий лабораторией генной инженерии растений ФГБНУ ВНИИ сельскохозяйственной биотехнологии;



А.К.Гапоненко - главный научный сотрудник Института биологии развития
им.Н.К.Кольцова РАН.

Общие положения

В Методике приводится процедура проведения детекции и идентификации специфических последовательностей ДНК генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени в матричном формате (ПЦР-матриц). В документе представлены требования к оборудованию, реактивам, подготовке проб, а также проведению анализа и интерпретации результатов.

1. Назначение и область применения ПЦР-матриц

1.1. Назначение ПЦР-матриц

Микроматрицы (ПЦР-матрицы) с иммобилизованными реактивами предназначены для выявления специфических последовательностей ДНК генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО) в тканях растений (семена, плоды, корнеплоды, зеленая масса), растительном сырье и продуктах его переработки. Детекция и идентификация осуществляется методом ПЦР с гибридационно-флуоресцентной детекцией продуктов ПЦР в режиме реального времени с использованием амплификатора нуклеиновых кислот "АриаДНА" или аналогичных.

1.2. Генетические элементы, определяемые с помощью ПЦР-матриц

Перечень тест-систем, для выявления специфичных для ГМО генетических элементов и определения видовой принадлежности образца, приведен в приложении 1.

Тест-системы могут быть иммобилизованы в ячейках ПЦР-матрицы в произвольном порядке. Схема ПЦР-матрицы описана в сопроводительной документации к каждому набору матриц.

Пример схемы ПЦР-матрицы приведен в приложении 2.

2. Оборудование и материалы

2.1. Используемое оборудование

- амплификатор нуклеиновых кислот в реальном времени, обеспечивающий проведение термоциклирования в микрореакторах, объемом до 1,5 мкл ("АриаДНА", Люмэкс-маркетинг, Россия или аналогичный);

- ламинарный бокс или бокс для ПЦР со встроенной системой УФ-облучения;

- спектрофотометр с рабочими длинами волн 260, 280 нм;

- холодильник бытовой электрический, с температурой морозильной камеры минус 20°C;



- микроцентрифуга настольная под пробирки вместимостью 1,5 мл, скорость вращения не менее 13000 мин⁻¹;
- аппарат для встряхивания типа "Вортекс" или микроцентрифуга-вортекс, скорость вращения до 3000 мин⁻¹;
- термостат твердотельный под одноразовые конические полипропиленовые пробирки с крышкой вместимостью 0,5 и 1,5 мл, диапазон поддерживаемых температур от 15°C до 120°C, количество гнезд - не менее 20 каждого типа, точность поддержания температуры - 0,2°C, разность температур между соседними ячейками - не более 0,5°C;
- весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г;
- гомогенизатор лабораторный;
- облучатель бактерицидный настенный;
- дозаторы механические с переменным объемом дозирования: 0,2-2,5 мкл с шагом 0,01 мкл; 0,5-10,0 мкл с шагом 0,01 мкл; 2-20 мкл с шагом 0,01 мкл; 20-200 мкл с шагом 0,1 мкл; 100-1000 мкл с шагом 1 мкл; 2-10 мл с шагом 0,1 мл;
- дозатор электронный с переменным объемом дозирования 0,5-10,0 мкл, обеспечивающий функцию диспенсирования (повторного дозирования);
- штативы для микропробирок объемом 0,5 мл и 1,5 мл.

2.2. Расходные материалы и реактивы

- пробирки одноразовые конические полипропиленовые микроцентрифужные вместимостью 0,2; 0,5; 1,5 мл;
- наконечники одноразовые с фильтром для дозаторов с переменным объемом дозирования до: 10; 20; 200; 1000 мкл;
- микроматрицы (ПЦР-матрицы) с иммобилизованными реактивами, подготовленные для детекции и идентификации ГМО в том числе в их смесях (ГенБит, Россия). Также могут использоваться ПЦР-матрицы для скрининговых исследований и специализированные ПЦР-матрицы для конкретных видов растений;
- буферный раствор для ПЦР с MgCl₂, концентрированный (10x);
- вода деионизированная;
- герметизирующая жидкость для предотвращения испарения реакционной смеси в процессе термоциклирования;
- набор реактивов для выделения ДНК;



- перчатки медицинские одноразовые, неопудренные.

3. Отбор образца семян для проведения анализа

Материал для анализа должен быть получен из достоверного, репрезентативного источника. Образец семян отбирается в соответствии с ГОСТом на соответствующую сельскохозяйственную культуру (см. приложение 3).

4. Порядок подготовки проб для проведения анализа методом ПЦР

Материалом для проведения ПЦР в режиме реального времени служат пробы ДНК, полученные из образцов семян, растительного материала, продуктов питания, продовольственного сырья, кормов и других источников.

4.1. Выделение ДНК из образцов

Выделение ДНК осуществляется в соответствии с инструкцией по применению к используемому набору реактивов для выделения.

Полученный препарат очищенной ДНК следует хранить при +4°C (кратковременное хранение, не более 6 часов) или в морозильной камере при -20°C (длительное хранение, до 6 месяцев).

Образец ДНК считается пригодным для анализа, если не содержит значительного количества примесей-ингибиторов ПЦР. Критерием оценки чистоты раствора ДНК следует считать следующее соотношение:

$$\frac{A_{260}}{280} = \frac{A_{260}}{A_{280}}$$

где A₂₆₀ - коэффициент поглощения раствора ДНК при длине волны 260 нм;

A₂₈₀ - коэффициент поглощения раствора ДНК при длине волны 280 нм.

Образец ДНК считается пригодным для анализа, если $1,75 < \frac{A_{260}}{280} < 1,90$.

5. Процедура проведения анализа

5.1. Подготовка ПЦР-матрицы

5.1.1 Перед использованием микроматрицы, необходимо убедиться в ее целостности, наличии штрих-кода и отсутствии трещин и сколов в реакционной зоне и на рабочей поверхности. Запрещено касаться реакционной зоны пальцами.

5.1.2 Аккуратно удалить защитную пленку с микроматрицы. Следить за сохранностью штрих-кода.



5.1.3 Вставить микроматрицу в картридж. Все манипуляции по введению растворов в микрореакторы проводить только в картридже.

5.1.4 Перед проведением анализа реакционную зону микроматрицы покрыть герметизирующей жидкостью в объеме 620 мкл для избежания испарения реакционной смеси во время термоциклирования. Герметизирующая жидкость должна покрывать всю реакционную зону однородным слоем, недопустимо образование пузырьков на поверхности жидкости.

После герметизации микроматрицы все дальнейшие манипуляции с картриджем должны обеспечивать ее горизонтальное расположение. Необходимо следить, чтобы герметизирующая жидкость не вытекала за пределы реакционной зоны через края подложки.

5.2. Подготовка проб

5.2.1. Отобрать и промаркировать микропробирки в соответствии с количеством анализируемых образцов и схемой ПЦР-матрицы.

5.2.2. В пробирки внести по **(N×0,15) мкл буферного раствора и по (N×1,35) мкл очищенного препарата ДНК**, где N - количество реакций (микрореакторов), в которых будет производиться анализ каждого из образцов.

5.2.2.1. В случае, если имеющегося объема препарата ДНК недостаточно для приготовления рабочей смеси, допускается разбавление раствора ДНК деионизованной водой в соотношении "ДНК деионизованная вода" не более 1:2 (v/v).

5.2.3. В случае, если схема микроматрицы предполагает проведение контрольных реакций ПЦР, в отдельную пробирку внести по **(N×0,15) мкл буферного раствора и по (N×1,35) мкл деионизованной воды**, где N - количество контрольных реакций (микрореакторов) ПЦР.

5.2.4. Полученные смеси тщательно перемешать, капли со стенок пробирок осадить кратким центрифугированием на центрифуге/вортексе (3 с).

5.2.5. В соответствии с топологией микроматрицы ввести смеси с образцами, подготовленными согласно подпункту 5.2.2, в соответствующие микрореакторы в объеме 1,2 мкл под слой герметизирующей жидкости (см. рис.1). Для этого наконечник с реакционной смесью погрузить под слой герметизирующей жидкости, подвести как можно ближе ко дну микрореактора и осторожно выдавить заранее определенный объем смеси в микрореактор. Реакционная зона ПЦР-матрицы имеет специальное покрытие, обеспечивающее попадание капли в микрореактор за счет гидрофобных взаимодействий.

Аналогично в микрореакторы для контрольных реакций ввести смесь, подготовленную согласно подпункту 5.2.3.



Рис.1. Введение реакционной смеси в микрореакторы.

5.3. Проведение амплификации с детекцией в режиме реального времени

Управление амплификатором "АриаДНА", в том числе и проведение анализа образцов, осуществляется при помощи программного обеспечения "Ariadna". Полная информация о проведении анализа представлена в Руководстве пользователя к программному обеспечению амплификатора нуклеиновых кислот в режиме реального времени "АриаДНА".

5.3.1. Поместить картридж с микропластиной в термоблок амплификатора. Во время проведения анализа термоблок должен быть плотно закрыт.

5.3.2. В основном окне программы выбрать меню "Анализ" (для создания нового проекта необходимо выбрать меню "Проект"). Во вкладке "Терморезим" меню "Анализ" установить программу амплификации:

Этап	Температура, ?С	Время, с	Количество циклов
1	94	120	1
2	94	5	45
	60*	30	

* На этом этапе происходит регистрация сигнала.

5.3.3. Назначить детекцию флуоресцентного сигнала в конце цикла амплификации. Во вкладке "Детектор" по двум каналам для флуорофоров FAM и ROX установить следующие



параметры:

Канал	Выдержка, мс	Усиление	Задержка, мс
FAM	1500	100	0
ROX	1000	100	0

5.3.4. Во вкладке "Шаблоны" определить микрореакторы микроматрицы по **Образцу и Каналам** в соответствии со схемой микроматрицы. Запустить программу амплификации.

5.3.5. После проведения анализа необходимо утилизировать использованную микроматрицу. Для этого необходимо извлечь картридж с микроматрицей из амплификатора. Извлечь микроматрицу из картриджа и поместить в утилизационную емкость, заполненную дезинфицирующим раствором.

5.3.6 После утилизации отработанной микроматрицы необходимо провести очистку картриджа безворсовой салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором.

5.4. Регистрация и интерпретация результатов

Регистрация результатов амплификации происходит в режиме реального времени. Изменение уровня флуоресценции в зависимости от номера цикла по каналам FAM и ROX отображается в закладке "Графики".

5.4.1. Анализ результатов проводится с помощью программного обеспечения амплификатора нуклеиновых кислот в режиме реального времени "АриаДНА".

5.4.2 В меню "Настройки графиков" необходимо отметить флажком опцию "Сглаживание" и установить следующие настройки расчетов:

Параметр	Значение
Длина волны циклов	2
Удалять фон	Экспоненциальный фон
Количество выбросов	2

5.4.3 Расчет пороговых циклов (C_t) производится программным обеспечением амплификатора автоматически. Номер рассчитанного порогового цикла доступен в закладке "Графики" (см. рис.2).

5.4.4 Результат анализа считается достоверным, если выполнены следующие условия:

- 1) Для положительного контроля ПЦР (в случае использования микрореактора с



положительным контролем) по каналам FAM и ROX значения порогового цикла (C_t) не превышают 35;

2) Для отрицательного контроля ПЦР (в случае использования микрореактора с отрицательным контролем) по каналам FAM и ROX флуоресцентный сигнал **не регистрируется**.

В противном случае результаты анализа считаются недействительными и рекомендуется повторная постановка.

5.4.5 Исследуемая специфичная ДНК **ОБНАРУЖЕНА**, если для соответствующего микрореактора значения порогового цикла (C_t) не превышают 35.

5.4.6 Исследуемая специфичная ДНК **НЕ ОБНАРУЖЕНА**, если для соответствующего микрореактора флуоресцентный сигнал **не регистрируется** или значение порогового (C_t) цикла превышает 35.

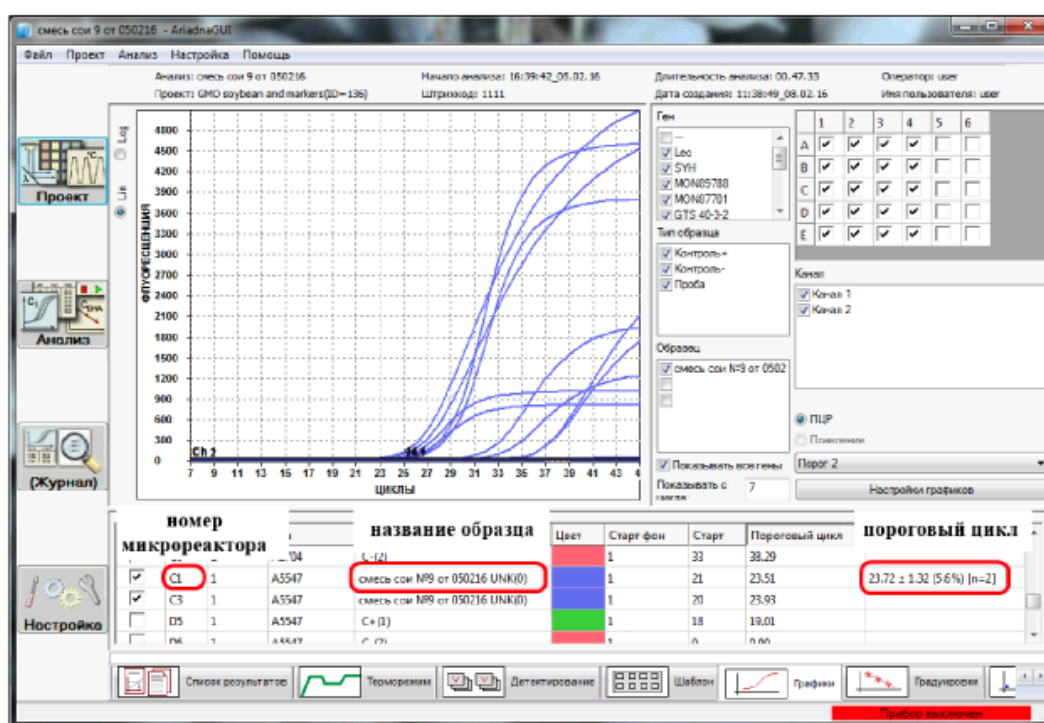


Рис.2. Общий вид закладки "Графики". Красными рамками выделены ячейки таблицы, соответствующие номеру микрореактора, названию исследуемого образца и пороговому циклу.

5.5. Определение содержания в образце ГМ-линий по выявленной комбинации генетических элементов

Если в образце обнаружены универсальные генетические элементы ГМО и маркеры видовой принадлежности, но не обнаружены конкретные ГМ-линии (трансформационные события), то образец содержит в своем составе незарегистрированные на территории Таможенного союза ГМ-линии. Определение ГМ-линий, содержащихся в образце, по комбинации выявленных генетических элементов возможно с использованием базы данных ГМ-культур (ГенБит, Россия) или других баз данных (GMOseek Software, <http://www.gmoseek.com/gmoseek>, CERA GMO Database <http://cera-gmc.org/GMCropDatabase>).



По окончании анализа распечатывается протокол исследований. Пример протокола приведен в приложении 4.

Приложение 1

Тест-системы для выявления специфичных для ГМО генетических элементов и определения видовой принадлежности образца

Код тест-системы	Описание
Линии генно-инженерно-модифицированной сои (ГМ-сои)	
GTS 40-3-2	трансформационное событие GTS 40-3-2
MON89788	трансформационное событие MON89788
MON87701	трансформационное событие MON87701
SYHT0H2	трансформационное событие SYHT0H2
A5547-127	трансформационное событие A5547-127
A2704-12	трансформационное событие A2704-12
FG72	трансформационное событие FG72
BPS CV-127-9	трансформационное событие BPS-CV127-9
Линии ГМ-кукурузы	
MON810	трансформационное событие MON810
NK603	трансформационное событие NK603
MON863	трансформационное событие MON863
GA 21	трансформационное событие GA21
MON88017	трансформационное событие MON88017
MON89034	трансформационное событие MON89034
T25	трансформационное событие T25
3272	трансформационное событие 3272
BT 11	трансформационное событие Bt11
MIR604	трансформационное событие MIR604
BT176	трансформационное событие Bt176



TC1507	трансформационное событие TC1507
MIR162	трансформационное событие MIR162
5307	трансформационное событие 5307
MZHGOJG	трансформационное событие MZHGOJG
Линии других ГМ-культур	
LLRICE62	ГМ-рис, трансформационное событие LL62
GT 73	ГМ-рапс, трансформационное событие GT73
H7-1	ГМ-сахарная свекла, трансформационное событие H7-1
Универсальные генетические элементы ГМО	
35S	35S промотор вируса мозаики цветной капусты
FMV	Промотор вируса мозаики норичника
pSsuAra	Промотор SsuAra A.thaliana
pTA29	Промотор, специфичный для пыльцы из N.tabacum
pNOS	NOS-промотор A. tumefaciens
pActin1 ¹	Промотор гена актина 1 риса
<p>¹ Результат определения данного генетического элемента не учитывается, если в образце содержится ДНК риса (определен маркер видовой принадлежности риса).</p>	
pUbiZM1 ²	Промотор гена убиквитина кукурузы
<p>² Результат определения данного генетического элемента не учитывается, если в образце содержится ДНК кукурузы (определен маркер видовой принадлежности кукурузы).</p>	
tNOS	NOS-терминатор A. tumefaciens
t35S	35S терминатор вируса мозаики цветной капусты
tE9	Терминатор E9 гороха
tOCS	Терминатор гена октопин-синтазы A.tumefaciens
tg7	Терминатор g7 A.tumefaciens
bar	Ген устойчивости к фосфинотрицину
Универсальные генетические элементы ГМО	



pat	Ген устойчивости к фосфинотрицину
gox/gox247	Ген глифосат-оксидазы
cp4 epsps	Ген устойчивости к глифосату
merpsps	Ген устойчивости к глифосату, мутантный
cry1Ab	Ген токсина cry1Ab B.thuringiensis
cry1Ac	Ген токсина cry1Ac B.thuringiensis
cry1F	Ген токсина cry1F B.thuringiensis
cry2Ab	Ген токсина cry2Ab B.thuringiensis
cry3A	Ген токсина cry3A B.thuringiensis
mcry3A	Модифицированный ген токсина cry3A B.thuringiensis
cry3Bb1	Ген токсина cry3Bb1 B.thuringiensis
cry34Ab	Ген токсина cry34Ab B.thuringiensis
cry35Ab	Ген токсина cry35Ab B.thuringiensis
cry9c	Ген токсина cry9c B.thuringiensis
cry1A.105	Ген токсина cry1A.105 B.thuringiensis
nptII	Ген неомицин-фосфотрансферазы
bla	Ген бета-лактамазы
gus	Ген бета-глюкуронидазы
Маркеры видовой принадлежности	
lec	Специфичная видовая последовательность сои
zea	Специфичная видовая последовательность кукурузы
Osat	Специфичная видовая последовательность риса
Bnap	Специфичная видовая последовательность рапса
Bvul	Специфичная видовая последовательность свеклы
Stub	Специфичная видовая последовательность картофеля
LAT	Специфичная видовая последовательность томата
TUB1	Специфичная видовая последовательность подсолнечника
ALMT1	Специфичная видовая последовательность пшеницы
AdhC	Специфичная видовая последовательность хлопчатника



SAD	Специфичная видовая последовательность льна
ACT	Специфичная видовая последовательность цикория

Приложение 2

Пример схемы ПЦР-матрицы

Соя (1 образец)

GTS 40-3-2	SYHT0H1	A5547-127	2merpsps	K+ pSsuAra/ 2merpsps	K+ INOS/pat	K+ (40-3-2/ 89788)	K+ (A5547-127/ Соя)
MON87701	BPS CV-127	A2704-12	pSsuAra	K+ cry1Ac/ bla	K+ cp4 epsps/ FMV	K+ (87701/ SYHT0H1)	K+ (FG72/ DP305423)
MON89788	DP305423	FG72			K+ IE9/p35S	K+ (BPS-CV127/ A2704-12)	K+ p35S/BKD
pat	soy	i35S	bla	K- pSsuAra/ 2merpsps	K- INOS/pat	K- (40-3-2/ 89788)	K- (A5547-127/ Соя)
FMV	p35S	IE9	cry1Ac	K- cry1Ac/ bla	K- cp4 epsps/ FMV	K- (87701/ SYHT0H1)	K- (FG72/ DP305423)
cp4 epsps	INOS	BKD			K- IE9/p35S	K- (BPS-CV127/ A2704-12)	K- p35S/BKD

Приложение 3

ГОСТы отбора проб семян различных сельскохозяйственных культур


N п/п	Наименование культуры	N ГОСТа	Наименование ГОСТа
1.	Сельскохозяйственные культуры, за исключением хлопчатника, сахарной свеклы, цветочных культур	ГОСТ 12036-85	Семена сельскохозяйственных культур. Правила приемки и методы отбора проб
2.	Сахарная свекла	ГОСТ 22617.0-77	Семена сахарной свеклы. Правила приемки и методы отбора проб
3.	Цветочные культуры	ГОСТ 24933.0-81	Семена цветочных культур. Правила приемки и методы отбора проб



4.	Картофель семенной	ГОСТ Р 55329-2012	Картофель семенной. Приемка и методы анализа
5.	Хлопчатник	ГОСТ 21820.0-76	Хлопок-сырец семенной и семена хлопчатника. Методы отбора проб

Приложение 4

Пример протокола исследований



ReportViewer - report

Файл Помощь

Время начала анализа, 12:38:42_13.07.16 Время создания отчета, 13:52:08_13.07.16

Прибор: с/н, emulation

Имя анализа: 12

Имя проекта: ГМО.Соя

Штрихкод: 003WL68

Результаты кратко

Имя	ВКО	p35S	tNOS	lec	FMV	pat	5547	2704	89788	87701	SYN 40-3-2	CV127	FG72	305423	cp4epsps	tE9	tE9
1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+
2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
официальный сайт
ФГБУ "Государственной комиссии
Российской Федерации по испытанию и охране
селекционных достижений"
<http://gossort.com> (сканер-копия)

Документ из профессиональной справочной системы «Техэксперт»
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru

Заказать бесплатную демонстрацию систем «Техэксперт»
Телефон: +7 (495) 730-07-66

ТЕХЭКСПЕРТ



компания ПРО-ИНФО

115419, г.Москва, ул. Орджоникидзе, д.11, стр.40, оф.7
Тел./факс: (495) 730-07-66, e-mail: tehexpert@proinfosoft.ru



по состоянию на 11.01.2017

Документ из профессиональной справочной системы «Техэксперт»
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru

Заказать бесплатную демонстрацию систем «Техэксперт»
Телефон: +7 (495) 730-07-66

ТЕХЭКСПЕРТ